

ACCU-CHEK® Aviva Plus
Blood Glucose Monitoring System


Roche

ENGLISH

Start Here

Quick Start Guide

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY


 Watch at accu-cheek.com

ACCU-CHEK®

WARNING

- Keep new and used batteries away from children. See the User's Manual for additional information.
- This Quick Start Guide does not replace the Owner's Booklet for your Accu-Chek Aviva blood glucose meter. The Owner's Booklet contains important cleaning and disinfecting procedures and additional information.
- The meter and lancing device are for single patient use. Do not share them with anyone, including other family members! Do not use on multiple patients!
- All parts of the kit are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases from bloodborne pathogens, even after you have performed cleaning and disinfecting.

Meter Overview

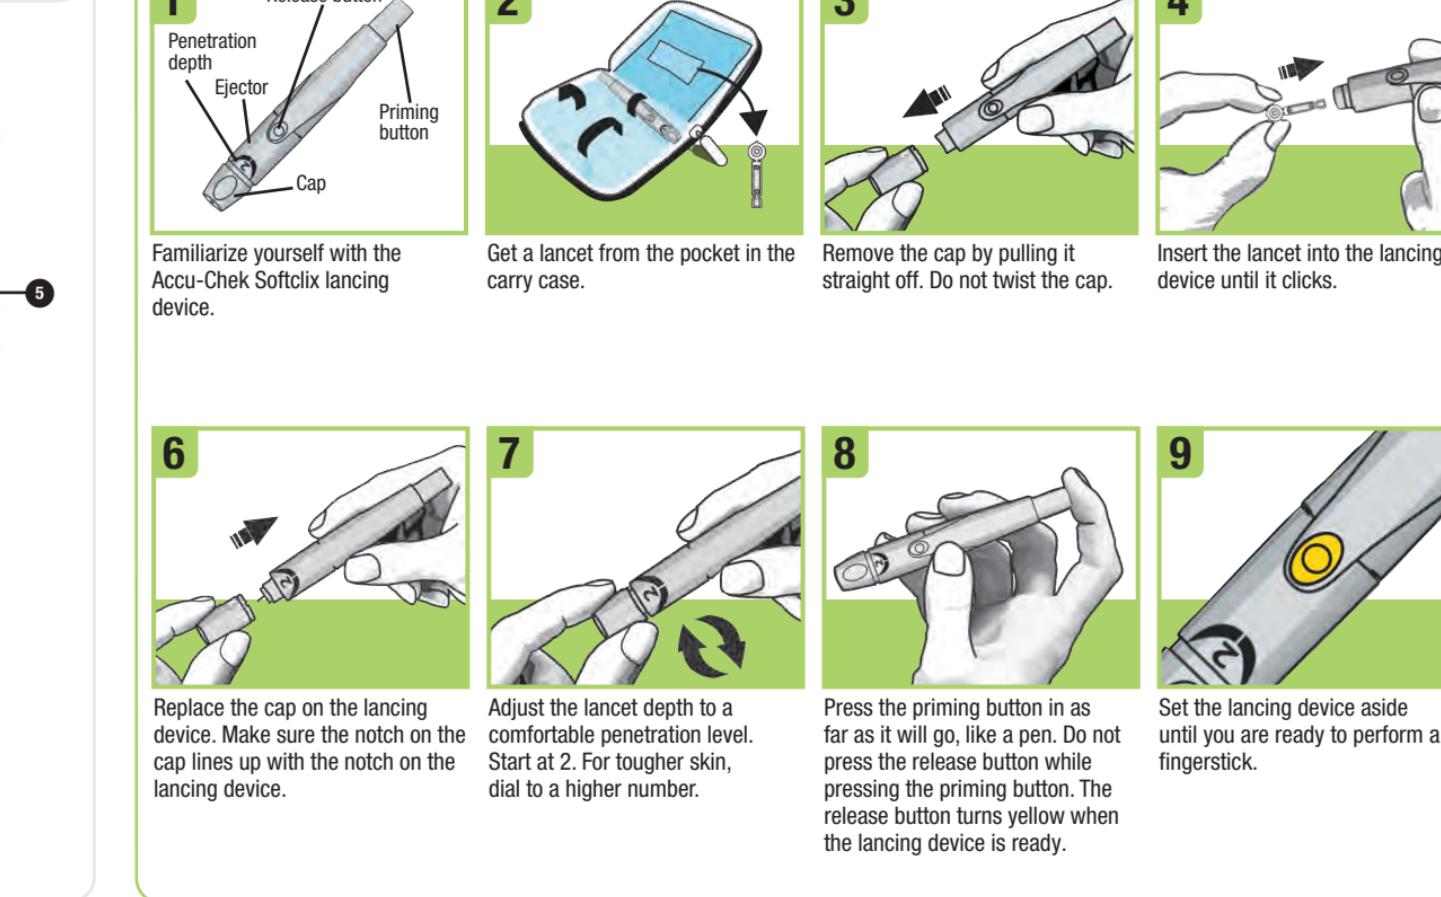

① Power/Set Button
② Display
③ Right Arrow and Left Arrow Buttons
④ Test Strip Slot
⑤ Battery Door
⑥ Infrared (IR) Window

Setting up the Lancing Device

- Familiarize yourself with the Accu-Chek Softclix lancing device.
- Get a lancet from the pocket in the carry case.
- Remove the cap by pulling it straight off. Do not twist the cap.
- Insert the lancet into the lancing device until it clicks.
- Twist off the lancet's protective cover.
- Wash and dry your hands **before** and **after** you perform a blood glucose test.
- Check the **Use By** date on the test strip container. Do not use test strips past the **Use By** date.
- Remove a test strip from the test strip container. Close the cap tightly.
- A flashing blood drop symbol appears.

Performing a Blood Glucose Test

- Replace the cap on the lancing device. Make sure the notch on the cap lines up with the notch on the lancing device.
- Adjust the lancet depth to a comfortable penetration level. Start at 2. For tougher skin, dial to a higher number.
- Press the priming button in as far as it will go, like a pen. Do not press the release button while pressing the priming button. The release button turns yellow when the lancing device is ready.
- Set the lancing device aside until you are ready to perform a fingerstick.
- Hold the lancing device firmly against the edge of your fingertip.
- Touch the end of the test strip to the blood drop. Do not put blood on top of the test strip.
- The meter beeps and **flashes**. The test result appears on the display after 5 seconds.
- Remove the lancing device cap. Point the lancet away from you. Slide out the ejector to release the lancet.

Error Messages

If any of the error messages below appear on the display at any time, refer immediately to the Owner's Booklet, Chapter 7, Display and Error Messages.

E-9 The battery is almost out of power. Change the battery now. If the message reappears after the battery has been replaced, remove the battery again, press any meter button, then reinsert the battery.

E-10 The time and date settings may be incorrect. Make sure the time and date are correct and adjust, if necessary.

NOTE
Contact the Accu-Chek Customer Care Service Center at 1-800-858-8072 if the error message continues.

Roche Diabetes Care, Inc.
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256
www.accu-cheek.com

ACCU-CHEK®, ACCU-CHEK AVIVA, and SOFTCLIX are trademarks of Roche.
© 2019 Roche Diabetes Care
07021917004-0719

ACCU-CHEK® Aviva Plus
Blood Glucose Monitoring System

Roche

ESPAÑOL

Empiece aquí

Guía rápida de instrucciones
ÚNICAMENTE PARA USO DE
UN PACIENTE INDIVIDUAL

Vé en **accu-cheek.com**

ACCU-CHEK®

ADVERTENCIA

- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Consulte las instrucciones de uso para obtener información adicional.
- Esta Guía rápida de instrucciones no reemplaza al Manual del usuario del medidor de glucemia Accu-Chek Aviva. El Manual del usuario contiene instrucciones importantes de limpieza y desinfección así como información adicional.
- El medidor y el dispositivo de punción están previstos únicamente para uso de un paciente individual. ¡No los comparta con nadie, ni siquiera con miembros de su familia! ¡No usar en varios pacientes!
- Todas las piezas del kit representan un peligro biológico y pueden transmitir enfermedades infecciosas a causa de patógenos nacidos de la sangre, incluso después de limpiarlas y desinfectarlas.

Visión general del medidor

1 Botón Power/Set (1)
2 Pantalla
3 Botones flecha derecha y flecha izquierda (◀ ▶)
4 Ranura de la tira reactiva
5 Tapa del compartimento de la pila
6 Ventana de infrarrojos (IR)

Ajustar el dispositivo de punción

- Familiarícese con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix.
- Saque una lanceta del bolsillo del estuche.
- Retire el capuchón tirando de él directamente hacia fuera. El capuchón no es de rosca.
- Inserte la lanceta en el dispositivo de punción hasta que encaje.
- Quite la cubierta protectora de la lanceta.
- Compruebe la fecha de caducidad (Use By) del tubo de tiras reactivas. Consulte el Manual del usuario, capítulo 4, Resultados de glucemia no esperados. Si el código E-3 aparece de nuevo después de su medición de glucemia, el resultado de glucemia puede ser extremadamente alto y superior al intervalo de medición del sistema. Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende inmediatamente. Si el segundo resultado de medición no coincide con cómo se siente, realice un control del funcionamiento con la solución de control y una tira reactiva nueva. Si el resultado de control está dentro del rango aceptable, lea de nuevo las instrucciones para el procedimiento de medición correcto y repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva. Si el resultado de control está fuera del rango aceptable, consulte el Manual del usuario, capítulo 2, Interpretar resultados de control fuera del rango aceptable.
- Empuje el botón tensor hasta el tope, como si fuera un bolígrafo. Ajuste la profundidad de punción a un nivel confortable. Empiece de que la muesca del capuchón esté alineada con la muesca del dispositivo de punción.
- Coloque el dispositivo de punción presionando firmemente contra el lado hasta que Ud. esté listo para efectuar una punción en la yema del dedo.
- Roce el extremo de la tira reactiva con la gota de sangre. No aplique sangre encima de la tira reactiva. Deje el dispositivo de punción a un lado hasta que Ud. esté listo para efectuar una punción en la yema del dedo.
- El medidor emite una señal sonora y parpadea cuando hay suficiente sangre en la tira reactiva. El resultado de medición aparece en la pantalla 5 segundos después.
- Vuelva a poner el capuchón en el dispositivo de punción. Asegúrese de que la muesca del capuchón esté alineada con la muesca del dispositivo de punción.
- Retire el capuchón del dispositivo de punción. No apunte la lanceta hacia Ud. Deslice el eyector para que salga la lanceta.

Realizar una medición de glucemia

- Lávese las manos y séquelas antes y después de realizar una medición de glucemia.
- Compruebe la fecha de caducidad (Use By) del tubo de tiras reactivas. Consulte el Manual del usuario, capítulo 4, Resultados de glucemia no esperados. Si el código E-3 aparece de nuevo después de su medición de glucemia, el resultado de glucemia puede ser extremadamente alto y superior al intervalo de medición del sistema. Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende inmediatamente. Si el segundo resultado de medición no coincide con cómo se siente, realice un control del funcionamiento con la solución de control y una tira reactiva nueva. Si el resultado de control está dentro del rango aceptable, lea de nuevo las instrucciones para el procedimiento de medición correcto y repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva. Si el resultado de control está fuera del rango aceptable, consulte el Manual del usuario, capítulo 2, Interpretar resultados de control fuera del rango aceptable.
- Coloque el dispositivo de punción presionando firmemente contra el lado hasta que Ud. esté listo para efectuar una punción en la yema del dedo.
- Roce el extremo de la tira reactiva con la gota de sangre. No aplique sangre encima de la tira reactiva. Deje el dispositivo de punción a un lado hasta que Ud. esté listo para efectuar una punción en la yema del dedo.
- El medidor emite una señal sonora y parpadea cuando hay suficiente sangre en la tira reactiva. El resultado de medición aparece en la pantalla 5 segundos después.
- Vuelva a poner el capuchón en el dispositivo de punción. Asegúrese de que la muesca del capuchón esté alineada con la muesca del dispositivo de punción.
- Retire el capuchón del dispositivo de punción. No apunte la lanceta hacia Ud. Deslice el eyector para que salga la lanceta.

Mensajes de error

E-8 La temperatura es superior o inferior al rango adecuado para el sistema. Consulte las condiciones de operación del sistema en el prospecto de las tiras reactivas. Vaya a un sitio con las condiciones apropiadas, espere 5 minutos y repita la medición de glucemia o el control del funcionamiento. No caliente ni enfrie el medidor por medios artificiales.

E-1 La tira reactiva puede estar dañada o no está insertada correctamente. Retire la tira reactiva y vuelva a insertarla o sustitúyala si está dañada.

E-3 Es posible que su nivel de glucemia sea extremadamente alto o que haya ocurrido un error en el medidor o en la tira reactiva. Si su resultado de medición coincide con cómo se siente, póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende inmediatamente. Si su resultado de medición no coincide con cómo se siente, repita la medición de glucemia no esperados. Si el código E-3 aparece de nuevo después de su medición de glucemia, el resultado de glucemia puede ser extremadamente alto y superior al intervalo de medición del sistema. Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende inmediatamente. Si el segundo resultado de medición no coincide con cómo se siente, realice un control del funcionamiento con la solución de control y una tira reactiva nueva. Si el resultado de control está dentro del rango aceptable, lea de nuevo las instrucciones para el procedimiento de medición correcto y repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva. Si el resultado de control está fuera del rango aceptable, consulte el Manual del usuario, capítulo 2, Interpretar resultados de control fuera del rango aceptable.

E-9 La pila está casi gastada. Cambie la pila ahora. Si el mensaje aparece de nuevo después de haber cambiado la pila, retire la pila, pulse cualquier botón del medidor y vuelva a insertar la pila.

E-10 Los ajustes de la hora y de la fecha podrían ser incorrectos. Asegúrese de que la hora y la fecha sean correctas y ajustelas si es preciso.

NOTA

Póngase en contacto con Accu-Chek Customer Care Service Center al 1-800-858-8072 si el mensaje de error persiste.

Roche Diabetes Care, Inc.
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256
www.accu-cheek.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA y SOFTCLIX son marcas registradas de Roche.
© 2019 Roche Diabetes Care
07021917004-0719